
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 1 de 3

EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SA19-400, se realizó el chat de grupo GABYS ESE HUEM, Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones.

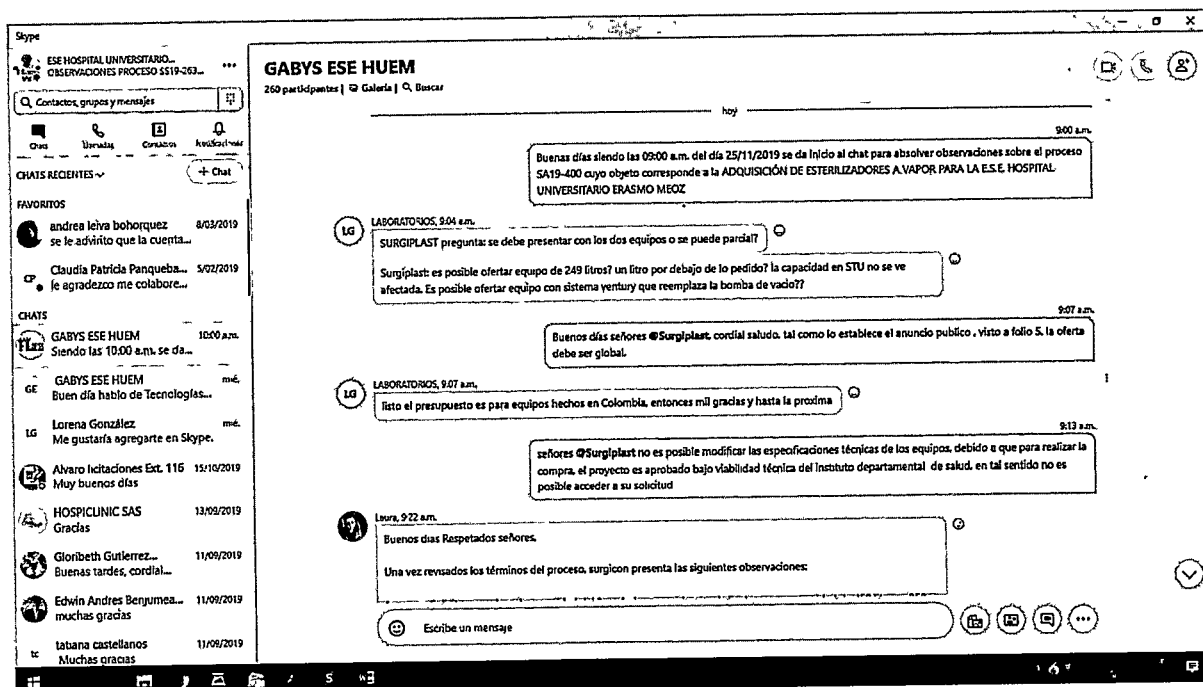

ESE, 9:00 a.m.

Buenas días siendo las 09:00 a.m. del día 25/11/2019 se da inicio al chat para absolver observaciones sobre el proceso SA19-400 cuyo objeto corresponde a la ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES A VAPOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

LABORATORIOS, 9:04 a.m.

SURGIPLAST pregunta: se debe presentar con los dos equipos o se puede parcial?

LABORATORIOS, 9:06 a.m.

Surgiplast: es posible ofertar equipo de 249 litros? un litro por debajo de lo pedido? la capacidad en STU no se ve afectada. Es posible ofertar equipo con sistema ventury que reemplaza la bomba de vacío??

ESE, 9:07 a.m.


Buenos días señores Surgiplast, cordial saludo, tal como lo establece el anuncio publico , visto a folio 5, la oferta debe ser global.

LABORATORIOS, 9:07 a.m.

listo el presupuesto es para equipos hechos en Colombia, entonces mil gracias y hasta la proxima

ESE, 9:13 a.m.

señores Surgiplast no es posible modificar las especificaciones técnicas de los equipos, debido a que para realizar la compra, el proyecto es aprobado bajo viabilidad técnica del instituto departamental de salud, en tal sentido no es posible acceder a su solicitud

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 2 de 3

Laura, 9:22 a.m.

Buenos dias Respetados señores,

Una vez revisados los términos del proceso, surgicon presenta las siguientes observaciones:

1. Solicitamos aclarar la capacidad del ítem 1 ; lo requerido por el cliente es una capacidad de 450 litros o 250 litros?
2. Solicitamos a la entidad ampliar el rango de 250 litros hasta 350 litros
3. Solicitamos a la entidad ampliar el rango de 400 litros hasta 490 litros para el ítem 2.
4. Por favor confirmar si la institución permitirá realizar visita técnica en sitio para verificar las preinstalaciones.
5. Solicitamos a la entidad se permita realizar el mantenimiento preventivo del equipo presencial en un término de 48 a 72 horas hábiles.
6. Solicitamos a la entidad, extender el plazo de ejecución del contrato, nótese que los diferentes proveedores somos importadores y los equipos se traen bajo pedido, generalmente los términos de importación serian de 60 a 90 días.
7. Solicitamos confirmar si la modalidad de contratación será por subasta inversa; de ser así es posible conocer los precios de referencia.
8. Confirmar el porcentaje mínimo para realizar los lances dentro de la subasta
9. Solicitamos extender el termino previsto para el cierre del proceso, lo anterior teniendo en cuenta el paro nacional.

ESE, 9:31 a.m.

señorita Laura cordial saludo,

ESE, 9:32 a.m.

Respecto al punto uno, la entidad aclara que la capacidad para el ítem 1 es de 250 L

ESE, 9:34 a.m.

respecto a los puntos 2 y 3 me permito informarle que las condiciones establecidas en el anuncio publico son las mínimas requeridas por la entidad, en tal sentido, si su propuesta es mejor o de mayor capacidad, es bienvenida siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas requeridas , y no sobrepase el valor del presupuesto.

ESE, 9:41 a.m.

En el presente proceso, no es necesaria la visita técnica, sin embargo , podrán presentarse en las instalaciones de la institución, si desean, para conocer las preinstalaciones como lo manifiestan, adicionalmente me permito informarle que el cierre del proceso no se extenderá, dando respuesta al punto 9, ya que el la fecha del paro nacional se llevo a cabo el 21 de Noviembre de 2019, y el cierre esta proyectado para el día jueves 28 de noviembre de 2019.

Laura, 9:43 a.m.

Por favor me confirma el valor del presupuesto


Laura, 9:43 a.m.

la solicitud de extension en el cierre del proceso se realiza teniendo en cuenta que en Bogota continuan las manifestaciones

ESE, 9:44 a.m.

respecto al punto 6, la entidad por ley de presupuesto trabaja por vigencia anual, esto es, que todos los procesos contractuales deben terminar el 31 de diciembre de 2019, en tal sentido no es posible acceder a su




	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 3 de 3

solicitud de ampliar el plazo de ejecución, así mismo, el presupuesto asignado a este proceso , corresponde a un proyecto de inversión aprobado por el instituto departamental de salud para la presente vigencia.

Laura, 9:47 a.m.

Por favor aclarar si es posible una vez adjudicado el proceso, emitir prorrogas en el plazo de ejecucion

ESE, 9:47 a.m.

respecto al punto 7 y 8, el presente proceso no se desarrollara con subasta inversa, pues no son condiciones uniformes.

ESE, 9:48 a.m.

Para Laura tal como lo establece el anuncio publico, visto a folio 9, el valor del presupuesto del proceso corresponde a \$ 393.437.800

ESE, 9:51 a.m.

por ultimo, como se dijo con anterioridad, somos una entidad publica que aplica ley de presupuesto por anualidad y/o vigencia, en tal sentido no es posible prorrogar el plazo de ejecución posterior al 31 de Diciembre de 2019

ESE, 9:54 a.m.

no obstante a pesar de que no se extenderá el cierre del proceso, los interesados podrán conforme a lo prescribe el anuncio publico , visto a folio 7, remitir la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.

Laura, 9:55 a.m.

agradezco la atencion prestada a nuestras observaciones, feliz dia

ESE, 10:00 a.m.

Siendo las 10:00 a.m. se da por finalizado el chat previsto dentro del proceso SA19-400, esperando haber resuelto las inquietudes suscitadas

Se expide a los 25 días del Mes de Noviembre de 2019.



SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativo

Revisó y aprobó: Mauricio Pinzón Barajas-Coordinador de adquisiciones bienes y servicios.
Proyectó: Kaleth Nycky Correa Gonzalez-Abogado ACTISALUD GABYS

