
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 1 de 7

EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS19-173, se realizó el chat de grupo **GABYS ESE HUEM**, Cuenta Skype: **ESE HUEM**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones.

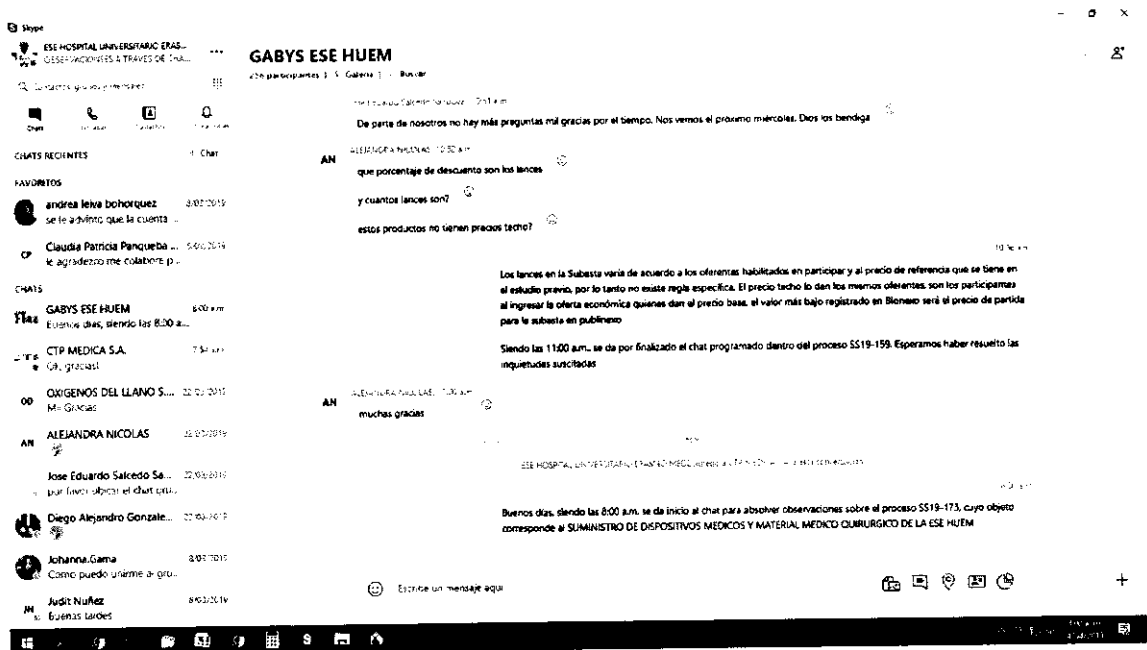

8:00 a.m.

Buenos días, siendo las 8:00 a.m. se da inicio al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS19-173, cuyo objeto corresponde al SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA ESE HUEM

CTP MEDICA S.A., 8:00 a.m.

Buen día mi nombre es carolina ay represento a CTP MEDICA

johnson johnson sa, 8:01 a.m.

Buen día,

Respetados Señores


Una vez revisado el proyecto de pliego de condiciones del proceso citado, Johnson & Johnson de Colombia S.A., se permite realizar las siguientes observaciones:

Observación 1

El Kit de accesorios Sterrad 100S, contiene las cajas recolectoras de cassettes y los platos del vaporizador que son necesarios para asegurar la Bioseguridad de los operarios del equipo; también contiene los rollos y cintas de impresión que hacen parte de los controles físicos del proceso de esterilización y son requisito de cumplimiento con el estándar Historia Clínica y registros (punto 4, Resolución 2003 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de habilitación de los servicios de salud, al igual que la Resolución 2183 por la cual se adopta el manual de Buenas prácticas en esterilización). El kit de accesorios forma parte del funcionamiento rutinario del equipo al igual que los cassettes, indicadores químicos, Biológicos y rollos de empaque.

4

ALC

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 2 de 7

Observación 2

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Donde especifica el siguiente numeral: 1. "Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo."

Se solicita amablemente a la Entidad aclarar si los pedidos que se realicen serán aceptados respetando la integridad del producto de cada proveedor y sus presentaciones comerciales e unidad de empaque para poder cumplir el numeral en mención

Observación 3

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupo 3 - Generales

Solicitamos amablemente incluir para el ítem - POLICLACTINA 910 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17MM HEBRA DE 45CMS O MÁS, la presentación de solo una aguja; Es de tener en cuenta que la ampliación de las características técnicas, conforme a lo expresado en el párrafo anterior no afectaría el objeto ni calidad de los mismos, por el contrario le ampliaría el rango de las casas comerciales susceptibles de participar en el mismo, proporcionándole a la entidad un mayor margen de ofertas y por ende, aplicación del principio de selección objetiva y transparente,

Observación 4

11. CRONOGRAMA

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad sea ampliado el plazo de presentación de ofertas en tres días hábiles, esto con el fin de lograr hacer la entrega de una oferta económica que satisfaga las necesidades del Hospital, teniendo en cuenta la complejidad e importancia del proceso en cuestión.

CTP MEDICA S.A., 8:01 a.m.

El representante Legal de la compañía se encuentra fuera de la ciudad, en su reemplazo se encuentra el primer suplente y es quien firmara la oferta a presentar, por favor indicar con qué tipo de documento debo soportar la ausencia del representante.

EN EL SARLAF hay un punto de información financiera (solo para contratación mínima y directa) es necesario diligenciarla para este tipo de oferta.

- Para el caso de los distribuidores debemos anexar los BPM de las casas fabricantes?
- Este proceso nuevamente tendrá subasta inversa? Y si es así se trabajara por publinexo?


8:07 a.m.

Señores Johnson sobre la observación 1, aunque no es clara la pregunta me permito aclarar que en cuanto a los accesorios del Grupo 1 Esterilización a baja temperatura como peroxido de hidrógeno, incluidos los que ustedes mencionan (cajas recolectoras, platos del vaporizador, rollos y cintas de impresión) luego de concertarlo internamente se estipuló para el presente proceso de selección como un valor agregado o bonificación que debe ser entregado por quien resulte adjudicatario del grupo en mención

CTP MEDICA S.A., 8:07 a.m.

La única fecha limite para hacer llegar la oferta física es el 09 de abril?

ALO

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 3 de 7

8:09 a.m.

Sobre la observación 2 de Johnson me permito manifestar que siempre se cumplan a cabalidad las especificaciones del Anuncio Público, así como la confirmación de Bionexo, dentro de estas (descripción del producto, valor, marca adjudicada y cantidades adjudicadas y solicitadas previamente por Bionexo) la entidad hospitalaria las recibirá sin objeción alguna

Luis Eduardo Garzon, 8:13 a.m.

Las siguientes son las observaciones de surgiplast. OBSERVACIONES E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

REFERENCIA: PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DEL PROCESO N° SS19-173

Respetuosamente nos permitimos enviar las siguientes observaciones al proyecto de pliego del proceso en referencia, la cual esperamos sea tenidas en cuenta por el comité estructurador para poder presentar nuestra propuesta permitiendo de parte de ustedes la pluralidad de oferentes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRUPO 1 - ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO.

OBSERVACION N 1:

PAGINA 1 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS"

Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS - FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 LITROS DOS PUERTAS). Tener en cuenta en el caso de ser adjudicado el proceso a la firma LABORATORIOS GOTHAPLAST Ltda., poder realizar la entrega de (1) un equipo con capacidad de 60 litros útiles y (1) un equipo con capacidad de 136 litros útiles para un total de 196 litros útiles de esterilización con peróxido de hidrogeno. Esta alternativa brinda a la central de esterilización del hospital Erasmo Meoz optimizar las cargas que esterilizan en sus turnos, ya que muchas cargas de este proceso al tener dos equipos de la misma capacidad no van a ocupar la totalidad de cámara dando un desperdicio significativo en litros de cámara que a su vez se ve reflejado en sobre costos para la institución.

OBSERVACION 2 DE CARÁCTER TECNICO GRUPO 1, ÍTEM 7, CODIGO: 20455:

Respetuosamente nos permitimos solicitar al comité técnico, si es posible ampliar el rango de medida del papel para esterilizar a baja de temperatura desde 38cm a 40cm.

OBSERVACION 3 DE CARÁCTER FINANCIERO.


Por medio del presente hacemos constar que conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía, el corte para la publicación de los estados financieros certificados definitivos de LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, Identificada con NIT 830.061.856-1 es anual, por tal motivo solicitamos a la entidad E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERASMO MEOZ solicitar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y/o 2018, esto para permitir mayor participación de oferente.

Gisella, 8:13 a.m. Buenos días, soy Gisella Garnica de grupo Amarey. Tengo varias dudas, 1. Los productos que se tendrán en cuenta deben tener concepto de evaluación técnica, es decir que se haya realizado trabajo de campo en la institución?

8:23 a.m. Sobre la observación 3 no es posible acceder a la solicitud de cambiar la especificación técnica del ítem 20685 - POLICLACTINA 910 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17MM

4

ALC

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 4 de 7

HEBRA DE 45CMS O MÁS, toda vez que por necesidad institucional se requiere esta presentación para cubrir los procedimientos quirúrgicos, y en cuanto a la limitación de ofertas que ustedes manifiestan me permito aclarar que el presente proceso se adelanta como consecuencia de la declaratoria desierta parcial del Proceso SS19-101, a través del cual se licitó y adjudicó en su oportunidad la presentación de una sola aguja.

Laura, 8:24 a.m. Buenos días,

1. Forma de Adjudicación: Solicitamos se permita la presentación y adjudicación de ofertas parciales POR ÍTEMS, lo anterior admitiendo la participación de pluralidad de oferentes y no forzando el principio de equidad que atiende el interés general.

2. Propuestas Alternativas: Solicitamos se tengan en cuenta aquellas propuestas que se presenten de manera alternativa; lo anterior permitiendo a la entidad recibir propuestas adicionales que representen beneficio en la parte técnica y económica.

8:26 a.m.

Teniendo en cuenta que los items del presente proceso ya fueron licitados previamente y que fueron declarados desiertos y se requieren con urgencia para cubrir la demanda de usuarios que requieren de los mismos, no es posible acceder a la solicitud de ampliación del cierre solicitada por el oferente Johnson en la observación 4

Luis Eduardo Garzon, 8:26 a.m.

Las siguientes son las observaciones de laboratorios Gothaplast: OBSERVACIONES E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

REFERENCIA: PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DEL PROCESO N° SS19-173

Respetuosamente nos permitimos enviar las siguientes observaciones al proyecto de pliego del proceso en referencia, la cual esperamos sea tenidas en cuenta por el comité estructurador para poder presentar nuestra propuesta permitiendo de parte de ustedes la pluralidad de oferentes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRUPO 1 – ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO.

OBSERVACION N 1:

PAGINA 1 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS"


Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS – FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 LITROS DOS PUERTAS). Tener en cuenta en el caso de ser adjudicado el proceso a la firma LABORATORIOS GOTHAPLAST Ltda., poder realizar la entrega de (1) un equipo con capacidad de 60 litros útiles y (1) un equipo con capacidad de 136 litros útiles para un total de 196 litros útiles de esterilización con peróxido de hidrogeno. Esta alternativa brinda a la central de esterilización del hospital Erasmo Meoz optimizar las cargas que esterilizan en sus turnos, ya que muchas cargas de este proceso al tener dos equipos de la misma capacidad no van a ocupar la totalidad de cámara dando un desperdicio significativo en litros de cámara que a su vez se ve reflejado en sobrecostos para la institución.

OBSERVACION 2 DE CARÁCTER TECNICO GRUPO 1, ÍTEM 7, CODIGO: 20455:

Respetuosamente nos permitimos solicitar al comité técnico, si es posible ampliar el rango de medida del papel para esterilizar a baja de temperatura desde 38cm a 40cm.

4

pid

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 5 de 7

OBSERVACION 3 DE CARÁCTER FINANCIERO.

Por medio del presente hacemos constar que conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía, el corte para la publicación de los estados financieros certificados definitivos de LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, Identificada con NIT 830.061.856-1 es anual, por tal motivo solicitamos a la entidad E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERASMO MEOZ solicitar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y/o 2018, esto para permitir mayor participación de oferente.

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 8:27 a.m.

Buenos dias, conforme al pliego de condiciones nos permitimos efectuar la siguientes observaciones:

1. Grupo N°3 – Generales, para el ítem 20330 INACTIVADOR DE DESECHOS ORGANICOS X 4000 C.C. se necesita conocer el proceso en el que será utilizado para saber qué clase de insumo podemos ofrecer, así mismo en el código 20587 STEN BILIAR AUTOEXPANDIBLE necesitamos aclarar si es parcial o totalmente recubierto y cuales medidas deben incluirse en la oferta

8:28 a.m.

Sobre el tema de los Representantes Legales suplentes debe revisarse lo dispuesto en la Cámara de Comercio (Certificado de Existencia y Representación Legal) de cada oferente, si no existe disposición particular al respecto en dicho documento, la ESE HUEM requiere que Certifiquen a través del área encargada (Por ejemplo: oficina de Talento Humano), la ausencia del Representante Legal Principal, caso en el cual deberán adjuntar todos los documentos legales del Representante Suplente.

Laura, 8:28 a.m.

3. Los equipos que se entreguen en calidad de comodato deberan ser asegurados en la póliza todo riesgo del comodatario, teniendo en cuenta que el uso de los equipos lo realizara el hospital y los posibles daños y fallas son responsabilidad del comodatario.

8:30 a.m.

CTP Si es necesario que se diligencie todos los campos del SARLAFT, incluida la información financiera, adicionalmente se recuerda que en la página 3 del formulario debe ser firmada por el representante legal, con impresión de su huella digital al lado de la firma

Laura, 8:30 a.m.

4. Solicitamos respetuosamente se tengan en cuenta los estdos financieros con corte a diciembre 2017, teniendo en cuenta que hasta este momento se estan dejando en firme los estados financieros con corte a diciembre 2018.

5. Solicitamos allegar formulario sarlaft en formato de word o excel


6. Vigencia de los productos: El proveedor podra acceder a esta solicitud, siempre y cuando el hospital allegue un informe mensual de sus inventarios, lo anterior teniendo en cuenta que el proveedor no puede realizar cambios ni devoluciones por productos vencidos o proximos a vencer , ni tampoco puede responder por la baja rotacion que tengan en la institucion; el manejo de inventarios recae directamente a la parte contratante.

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 8:39 a.m.

Solicitamos que para los codigos 21037, 20600,20599, correspondientes a HEMOSTATICOS DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA la institucion tenga encuesta para la evaluacion de cumplimiento adicionalmente a la ficha tecnica, una evaluacion tecnica del producto avalada por la institucion ya que en el mercado se encuentran productos con precios artificialmente bajos que no

ok

ok

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 6 de 7

cumplen con la necesidad y que una vez adjudicados representan un riesgo en el proceso contractual, y reportes de no conformidades.

8:39 a.m.

CTP Revisado el Anuncio Público no se citó los Certificados de BPM, para el Cierre del Proceso solo deben adjuntar las fichas técnicas de los ítems solicitados en el Anuncio, así como de los equipos en apoyo tecnológico e igualmente deben adjuntar la póliza de Seriedad de la Oferta

CTP de conformidad con el Cronograma del proceso si aplica la etapa de Subasta Inversa, la cual se efectúa a través de la plataforma Publinexo con los oferentes que han superado satisfactoriamente las demás etapas

CTP El cierre del proceso es el 09 de abril a las 11 a.m., fecha en que deben ser registrados los precios de los ítems a ofertar en la plataforma de Bionexo y adicionalmente deben llegar las fichas técnicas en físico a la oficina de Gerencia de la ESE HUEM.

En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas EXCLUSIVAMENTE a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.

8:50 a.m.

Surgiplast, sobre el apoyo tecnológico del grupo 1 debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Acápite de especificaciones técnicas del Anuncio Público, así como el PARÁGRAFO: Se puede recibir temporalmente esterilizadores de una sola puerta mientras se hace el arreglo de infraestructura en la central de esterilización, con el compromiso de que cuando se requiera el de doble puerta, esté disponible inmediatamente.

Surgiplast Sobre el papel para esterilizar a baja temperatura, también debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Acápite de especificaciones técnicas del Anuncio Público, puesto que siempre esta medida es la que ha cubierto la necesidad institucional.

Sobre las inquietudes suscitadas por el corte de los Estados Financieros, debe tenerse en cuenta lo dispuesto a folio 21 del Anuncio Público: "En el evento de acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros se realizan por periodo anual, se admitirán los Estados Financieros vigentes para la época certificados por el Representante Legal y el Contador de la Empresa". En consecuencia, serán admisibles estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 o 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando sean Certificados que conforme a los estatutos particulares de cada empresa los indicadores financieros son anuales.

Amarey en el presente proceso el trabajo de campo no es requisito previo para la adjudicación, para ello, se revisan las fichas técnicas, de los ítems relacionados en el Anuncio Público por parte de los especialistas, quienes con fundamento en su experticia y experiencia profesional conceptúan sobre el cumplimiento de las características técnicas de los ítems. En cuanto al acápite 5 del Anuncio vista a folio 15, la adjudicación del proceso se realizará así:

GRUPO 1 ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO (PARA USO CON EQUIPO EN COMODATO). OFERTA POR GRUPO.


GRUPO 2 EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL: OFERTA POR GRUPO.

GRUPO 3 GENERALES: OFERTA POR ITEMS.

Luis Eduardo Garzon, 8:57 a.m. Gothaplast. El rollo de 40 cm de tuve es el que se está entregando actualmente y desde hace 8 meses, pedimos formalizar el tamaño y se deje el rango de 38 cm a 40 cm. De tyvek *

sk

pclo

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 7 de 7

9:00 a.m.Hospiclinic

El proceso del ítem 20330 es inactivar desechos orgánicos, las medidas son solicitadas dependiendo de la valoración del cirujano al paciente

Surgicon Claro la entidad hospitalaria responderá cuando por su culpa presenten fallas los equipos entregados en comodato, pero no responderá en el evento de que ocurran daños por fuerza mayor o caso fortuito riesgos que deberán ser amparados por una poliza todo riesgo del comodatario

El sarlaft se recomienda imprimir el documento y diligenciar a mano, no es posible publicarlo en medio editable

sobre la vigencia de los productos se recuerda lo dispuesto en el Anuncio 4) VIGENCIA PRODUCTOS: Los productos entregados deben venir con una fecha de vencimiento mínima del 75% de su vida útil. PARÁGRAFO: No obstante, cuando los dispositivos adjudicados sean considerados de alta rotación, previa autorización del Servicio Farmacéutico, podrán entregarse con vigencia inferior a la prevista con antelación, debiendo adjuntar para tales fines, carta de compromiso de reponerlo en el evento de vencerse antes de su uso. No es posible acceder a cambios sobre este punto

Laura, 9:06 a.m.

por favor atender observacion a cerca del tipo de adjudicacion, sera posible oferta y adjudicar por ítem el grupo 1

9:06 a.m.Sobre los códigos 21037, 20600,20599, para eso se solicitan las fichas técnicas para que sean evaluadas por el area que maneja los insumos quien dará el concepto técnico de cumplimiento del mismo

Laura su observación sobre la adjudicación no era clara, en todo caso no es posible realizar oferta parcial para el grupo 1 toda vez que se requiere del apoyo tecnológico de dos esterilizadores, junto con los insumos necesarios para la impresión de resultados

siendo las 9:08 a.m. se da por finalizado el chat esperando haber resuelto las inquietudes suscitadas dentro del proceso SS19-173

Laura, 9:08 a.m.

Gracias

johnson johnson sa, 9:09 a.m.


Muchas Gracias

CTP MEDICA S.A., 9:11 a.m.

Gracias!

Se expide a los cuatro (4) días del mes de abril de 2019


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
 Subgerente de Servicios de Salud (e)


 Aprobó: Mauricio Pinzon Barajas, Coordinador Actisalud GABYS
 Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud GABYS